



**Laboratorio Nacional de Referencia  
(RD 102/2011 de 28 de enero)**

**INFORME FINAL EI 01/2019(G1)  
DEL III EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MONÓXIDO DE NITROGENO Y DE DIÓXIDO DE  
NITROGENO DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS DE  
INTERCOMPARACIÓN“IN SITU” DE GASES  
ATMOSFÉRICOS (2018)**

 <p>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</p> <p>Laboratorio Nacional de Referencia (RD 102/2011 de 28 de enero)</p>	<p><b>INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE NITROGENO. GRUPO 1. (2018)</b></p>	
---	--	---

## 1 OBJETO

El objeto del programa de ejercicios de intercomparación de medida “in situ” de gases atmosféricos desarrollado por el Área de Contaminación Atmosférica (ACA) del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es garantizar a los organismos participantes la trazabilidad y la calidad de los datos generados por sus analizadores.

La participación en ejercicios de intercomparación permite a las redes de medida de la calidad del aire y/o laboratorios de calidad del aire que participan en los mismos, evaluar el desempeño, verificar la adecuación de los procedimientos que utilizan para la determinación de contaminantes atmosféricos en aire ambiente, y en el caso concreto de las redes de calidad del aire, cumplir con los objetivos de calidad de los datos establecidos en la legislación (Anexo V del RD 102/2011 de 28 de enero, modificado por Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire). En definitiva, los objetivos de estos ejercicios de intercomparación son:

- garantizar a las redes de vigilancia de la calidad del aire en España la trazabilidad y la calidad de los datos;
- cumplir con los objetivos de calidad de los datos fijados en la legislación pertinente, y
- garantizar que las distintas redes proporcionen datos comparables y que la evaluación (medición) de la calidad del aire se realice de una forma armonizada.

En el marco del citado programa de ejercicios de intercomparación de medida “in situ” de gases atmosféricos, el ISCIII ha organizado en el año 2018 el III ejercicio de intercomparación “in situ” de NO y de NO<sub>2</sub>.

## 2 ANTECEDENTES

Con fecha 29 de enero de 2011 se publicó el RD 102/2011, de 28 de enero, modificado por Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, según el cual el Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) del ISCIII es designado Laboratorio Nacional de Referencia de calidad del Aire, y como tal tiene, entre otras funciones, la coordinación a escala nacional de la correcta utilización de los métodos de referencia y la demostración de la equivalencia de los métodos que no sean de referencia.

Además, el citado RD indica en el punto III del anexo V que:

*III. Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente: Verificación de los datos. Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los datos fijados en el apartado I, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del artículo 3.3.a) deberán:*

*a) Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10, de conformidad con los requisitos establecidos en la norma armonizada aplicable a los laboratorios de ensayo y calibración, es decir, la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: «Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración».*

Desde el año 2010 el ISCIII organiza anualmente, ejercicios de intercomparación “in situ” de gases atmosféricos en el laboratorio de intercomparaciones del Área de Contaminación Atmosférica del Centro Nacional de Sanidad Ambiental.

El ACA tiene implantado un sistema de calidad UNE-EN ISO/IEC 17025 y está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como laboratorio de ensayo desde el año 2000. En el alcance de su acreditación 223/LE460 se incluyen los métodos de determinación de contaminantes gaseosos SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO y C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> en aire ambiente de acuerdo a los métodos de referencia establecidos en el RD 102/2011, y en la Directiva 2015/1480/CE.

Por otro lado, el ISCIII es, a través del ACA del CNSA, laboratorio asociado al Centro Español de Metrología por ser depositario del Patrón Nacional de Ozono (RD 250/2004 de 6 de febrero, modificado por el RD 1587/2009 de 16 de octubre), lo cual lo sitúa en el nivel más alto de la cadena metrológica para este parámetro.

En este marco metrológico y para dar cumplimiento a la legislación vigente el ACA, como Laboratorio Nacional de Referencia, participa periódicamente en los ejercicios de intercomparación comunitarios organizados por el Laboratorio de Referencia Europeo para la Contaminación Atmosférica (ERLAP) del Joint Research Centre (JRC) y cuenta para ello con un Laboratorio de Intercomparaciones destinado a la organización de intercomparaciones de medida “in situ” de gases en aire ambiente.

## **2 PLANIFICACIÓN**

En marzo de 2018, el ISCIII informó a las redes de calidad del aire de la organización durante el segundo semestre de 2018 de un ejercicio de intercomparación “in situ” de NO y NO<sub>2</sub>, en el laboratorio de intercomparaciones del ISCIII. Para ello, se envió, vía mail, un formulario de registro en el ejercicio de intercomparación, que fue contestado afirmativamente por 18 redes.

El ejercicio fue programado en tres fechas distintas con 6 participantes en los grupos 1 y 2, y 8 participantes en el grupo 3:

Grupo 1: del 22 al 23 de noviembre de 2018

Grupo 2: del 26 al 27 de noviembre de 2018

Grupo 3: del 28 al 29 de noviembre de 2018

En el mes de julio, el ISCIII remitió por correo electrónico a los participantes, la documentación que se cita a continuación, solicitando además la confirmación final de asistencia al ejercicio:

- Protocolo para la organización de ejercicios de intercomparación de gases “*in situ*”;

En el mes de octubre, el ISCIII remitió por correo electrónico la siguiente información:

- Listado de participantes, distribución y fechas.

Finalmente, confirmaron su asistencia al ejercicio de intercomparación de CO y SO<sub>2</sub> en las fechas correspondientes al grupo 1, los siguientes participantes:

- Andalucía (Red de calidad del aire)
- País Vasco
- Baleares
- Galicia
- Portugal
- Navarra

El personal participante del ISCIII, fue:

D. José Miguel de Miguel Gómez

D.ª María de los Desamparados Soriano Rodríguez

D.ª Patricia Abad Valle

Con el fin de preservar la confidencialidad de los resultados, los distintos participantes han sido identificados con un código alfanumérico X\_Y, donde X es una letra correlativa del alfabeto e Y se corresponde con el número de grupo en el que se ha participado. Este informe corresponde al grupo 1 de la intercomparación de NO y NO<sub>2</sub> de 2018.

### **3 DESARROLLO DEL EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN**

#### **3.1 CRONOGRAMA**

La duración del ejercicio de intercomparación fue de 2 días, contando con el tiempo necesario para la instalación, estabilización y desmontaje de los equipos, siendo el cronograma final el siguiente:

➤ Día 22/11/2017:

- 08:30 h a 11:00 h: Llegada de los participantes, instalación de los equipos en los distintos puestos de trabajo.
- 11:00 h a 13:30 h: Comprobación del estado de los analizadores (verificación/calibración y/o diagnósticos y mantenimientos que cada participante considere pertinente).
- 13:30 h a 14:30 h: Comida en la cafetería del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
- 14:30 h a 18:00 h: Inicio de la intercomparación. Generación de las mezclas de gas de intercomparación y medición por parte de los participantes.

➤ Día 23/11/2017:

- 08:30 h a 10:30 h: Generación de las últimas mezclas de gas. Finalización de la intercomparación.
- 10:30 h a 12:30 h: Recogida de datos, comprobación del estado de los analizadores si procede y desinstalación de los equipos.

### 3.2 EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO

Cada participante aportó el equipo (anализador, material de referencia, aire cero y sistema de adquisición de datos), que consideraron necesario para la comprobación “in situ” del estado de su analizador de NO<sub>x</sub> (verificación/calibración previa al ensayo), la realización de las mediciones y la adquisición de datos del gas de ensayo.

Las tabla 1 muestra los analizadores aportados por cada participante para la realización del ejercicio de intercomparación en el ISCIII:

MARCA/MODELO
Teledyne API T200
Thermo 42i
Teledyne API T200
Teledyne API T200
Horiba Apna-370
Teledyne API T200

Tabla 1 – Analizadores de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno aportados por los distintos participantes

### 3.3 ITEMS DE ENSAYO

Los ítems de ensayo son mezclas de gas de concentración conocida, generadas a partir de un material de referencia certificado, un gas de dilución que no debe contener el máximo de impureza permitida del gas que se va comparar y de un sistema de dilución dinámica.

Por tratarse de ítems de ensayo, producidos y medidos “in situ”, no procede almacenamiento, manipulación o distribución de los mismos. Sin embargo, debe evaluarse la distribución uniforme de la mezcla a lo largo del sistema de distribución.

Las mezclas de gas para la comparación de NO y NO<sub>2</sub> se generaron mediante un generador de aire cero y un sistema de dilución dotado de dos controladores de caudal másico, con capacidad suficiente para garantizar el caudal necesario y la distribución uniforme de la mezcla de gas a cada participante, en el caso del NO<sub>2</sub>, además se utilizó el generador de O<sub>3</sub> del mismo banco de dilución. El ISCIII, a su vez, midió las concentraciones generadas mediante la utilización de dos analizadores de NO<sub>x</sub>, situados al principio y final de la línea de distribución con el fin de confirmar que no se produce ninguna incidencia que pueda afectar a la medida a lo largo de la misma. Los equipos empleados para la generación de las concentraciones de NO y NO<sub>x</sub> son los que se describen a continuación:

- Sistema de dilución dotado de dos controladores de caudal másico y un generador de O<sub>3</sub>, marca MCZ, código interno ZA-JÑ-01;
- Analizador de NO<sub>x</sub>, marca THERMO ENVIRONMENTAL 42i código interno ZA-AN-42.
- Analizador de NO<sub>x</sub>, marca API/M200E código interno ZA-AN-52.

- Sistema de filtrado de aire cero, marca MCZ, código interno ZA-AZ-04.

El material de referencia empleado para la generación de las mezclas de gas fue el siguiente:

Mezcla de NO/N <sub>2</sub> :	Fabricante:	Carburos Metálicos.
	Concentración:	80,295 nmol/mol
	Incertidumbre:	± 0,803 nmol/mol
	Fecha de caducidad:	04/01/2019
	Certificado:	8199/17

### 3.4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Para la realización del ejercicio de intercomparación se generó un gas cero (c0) y cinco concentraciones diferentes de NO y NO<sub>2</sub> (c1, c2, c3, c4 y c5), con una concentración teórica máxima de 265 nmol/mol de NO y de 152 nmol/mol de NO<sub>2</sub>, respectivamente.

El gas cero se generó durante una hora y media, desechándose la primera hora y tomando como resultado de la comparación el promedio de 30 min de la siguiente media hora. El resto de las concentraciones se generaron durante un periodo de tiempo de 1h y 30 min. La primera media hora se desechó al considerarse periodo de estabilización y de la siguiente hora se realizaron tres medidas de cada concentración (tomadas como promedios de 20 min), excepto la primera concentración de NO que se generó durante 2 horas, desechándose la primera hora.

La figura 1 muestra la secuencia de concentraciones generadas para el ejercicio de intercomparación:

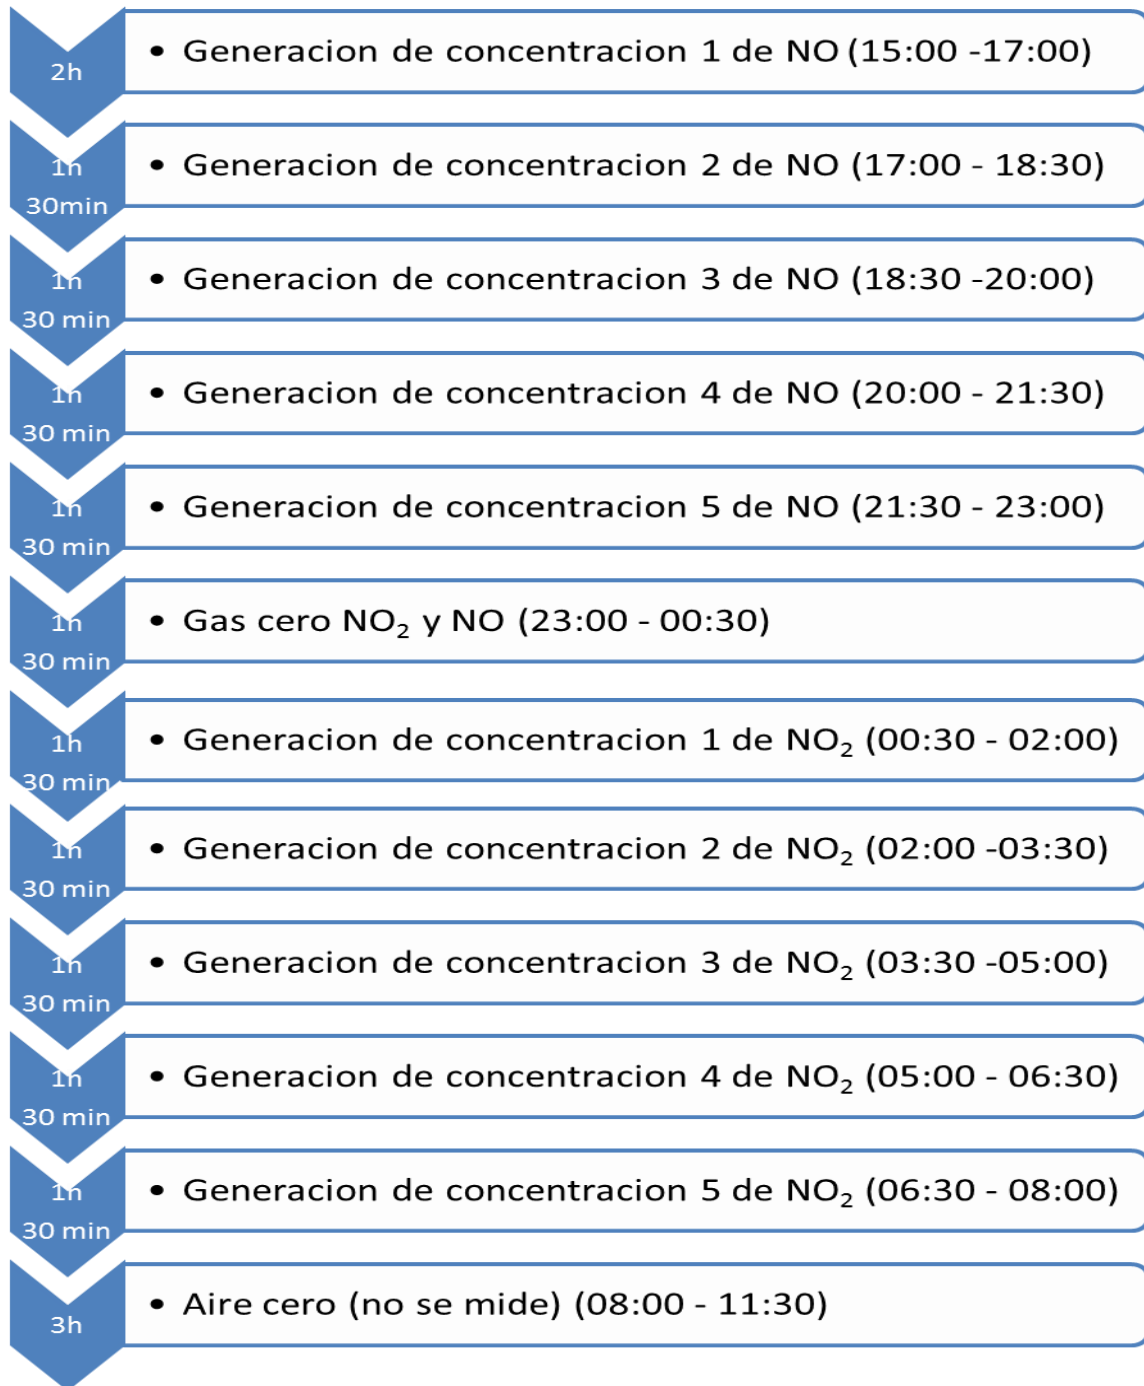


Figura 1: Cronograma de la generación de concentraciones de NO y NO<sub>2</sub>





## 4 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE LOS PARTICIPANTES

### 4.1 Monóxido de nitrógeno

Las tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 muestran los resultados obtenidos por cada participante para cada una de las concentraciones (c0, c1, c2, c3, c4 y c5) generadas durante el ejercicio de intercomparación para NO.

PARTICIPANTE	c0
A_1	-0,39
B_1	0,73
C_1	0,10
D_1	-0,05
E_1	0,34
F_1	0,00

Tabla 2. - Resultados de la concentración c0 de NO informada por los distintos participantes.

PARTICIPANTE	c1	U (k=2)
A_1	209,32	14,00
B_1	205,01	9,71
C_1	210,49	6,30
D_1	204,30	4,28
E_1	205,00	12,00
F_1	206,24	9,34

Tabla 3. - Resultados de la concentración c1 de NO informada por los distintos participantes.



**INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)**



PARTICIPANTE	c2	U (k =2)
A_1	111,80	7,66
B_1	116,51	5,65
C_1	113,98	3,40
D_1	110,49	3,00
E_1	109,90	6,40
F_1	112,07	5,34

Tabla 4. - Resultados de la concentración c2 de NO informada por los distintos participantes.

PARTICIPANTE	c3	U (k =2)
A_1	144,27	9,77
B_1	150,27	7,09
C_1	145,54	4,40
D_1	142,44	3,24
E_1	142,00	8,30
F_1	143,53	5,34

Tabla 5. - Resultados de la concentración c3 de NO informada por los distintos participantes.

PARTICIPANTE	c4	U (k =2)
A_1	63,46	4,55
B_1	74,78	3,68
C_1	65,74	2,00
D_1	64,27	2,52
E_1	63,50	3,80
F_1	64,65	5,34

Tabla 6. - Resultados de la concentración c4 de NO informada por los distintos participantes.



PARTICIPANTE	c5	U (K =2)
A_1	256,75	17,09
B_1	258,53	11,99
C_1	258,00	7,70
D_1	251,89	4,72
E_1	250,00	15,00
F_1	254,26	9,34

Tabla 7. - Resultados de la concentración c5 de NO informada por los distintos participantes.

#### 4.2 Dióxido de nitrógeno

Las tablas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 muestran los resultados obtenidos por cada participante para cada una de las concentraciones (c0, c1, c2, c3, c4 y c50) generadas durante el ejercicio de intercomparación para NO<sub>2</sub>.

PARTICIPANTE	c0
A_1	0,01
B_1	0,50
C_1	0,14
D_1	-0,47
E_1	0,77
F_1	0,00

Tabla 8. - Resultados de la concentración c0 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

PARTICIPANTE	C1	U (k =2)
--------------	----	----------



**INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)**



<b>A_1</b>	106,65	7,04
<b>B_1</b>	102,56	4,90
<b>C_1</b>	103,71	11,41
<b>D_1</b>	105,62	5,72
<b>E_1</b>	96,57	8,70
<b>F_1</b>	102,70	5,34

Tabla 9. - Resultados de la concentración c1 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

“---” no participa.

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>C2</b>	<b>U (k =2)</b>
<b>A_1</b>	54,68	3,70
<b>B_1</b>	52,85	2,71
<b>C_1</b>	52,24	5,75
<b>D_1</b>	55,95	4,04
<b>E_1</b>	46,40	4,20
<b>F_1</b>	52,64	5,34

Tabla 10. - Resultados de la concentración c2 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

“---” no participa.

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>C3</b>	<b>U (k =2)</b>
<b>A_1</b>	178,88	11,74
<b>B_1</b>	172,63	8,06
<b>C_1</b>	176,31	19,39
<b>D_1</b>	176,85	7,40
<b>E_1</b>	168,00	15,00
<b>F_1</b>	175,58	5,34

Tabla 11. - Resultados de la concentración c3 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

“---” no participa.

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>C4</b>	<b>U (k =2)</b>
---------------------	-----------	-----------------



A_1	80,48	5,35
B_1	78,72	3,87
C_1	79,02	8,69
D_1	82,13	4,60
E_1	72,40	6,50
F_1	78,86	5,34

Tabla 12. - Resultados de la concentración c4 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

“---” no participa.

PARTICIPANTE	C5	U (k=2)
A_1	154,07	10,12
B_1	150,41	7,05
C_1	152,06	16,73
D_1	153,69	7,14
E_1	145,00	13,00
F_1	151,18	5,34

Tabla 13. - Resultados de la concentración c5 de NO<sub>2</sub> informada por los distintos participantes

“---” no participa.

## 5 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

El tratamiento estadístico diseñado para el programa de ejercicios de intercomparación de medida “in situ” de gases atmosféricos y por tanto para el presente ejercicio de intercomparación de NO y NO<sub>2</sub>, incluye:

- Comprobación de la distribución uniforme de las mezclas de gas.
- Determinación del valor asignado como valor de referencia y de su incertidumbre típica.
- Comprobación por comparación del valor asignado y su incertidumbre típica con parámetros obtenidos por estadística robusta.
- Determinación de la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación.

### 5.5.1 Comprobación de la distribución uniforme de las mezclas de gas

La comprobación de la distribución uniforme de la muestra se realiza “in situ” en el mismo momento en que se está realizando la comparación. Para ello, los analizadores de referencia instalados al inicio (analizador ISCI<sub>III</sub>\_A) y al final (analizador ISCI<sub>III</sub>\_B), del distribuidor, han medido a la vez y en las mismas condiciones que los participantes durante todo el ejercicio de intercomparación. De este modo, se han obtenido dos grupos de observaciones (analizador ISCI<sub>III</sub>\_A y analizador ISCI<sub>III</sub>\_B) que se emplean para comprobar que la mezcla que miden todos los participantes es la misma.

A partir de los resultados de este ensayo se calcula la incertidumbre típica debido a la falta de uniformidad de la mezcla ( $u_{\text{uniformidad}}$ ) a lo largo del sistema de distribución, la cual se tiene en consideración en la estimación de la incertidumbre del valor asignado.

Para comprobar si realmente existe una diferencia significativa entre la mezcla medida por el analizador A situado al inicio del distribuidor de muestra y la medida por el analizador B situado al final del mismo, se realiza la determinación del estadístico D, calculado según establece el anexo A de la Norma UNE-EN ISO 16664:2008, de acuerdo con la ecuación:

$$D = \frac{x_{i,ISCI_{III}_A} - x_{i,ISCI_{III}_B}}{\sqrt{u_{ISCI_{III}_A}^2 + u_{ISCI_{III}_B}^2}}$$

donde

- $x_{i,ISCI_{III}_A}$  es la concentración de gas medida por el analizador ISCI<sub>III</sub>\_A, situado al inicio de la línea de distribución, en nmol/mol para el SO<sub>2</sub> y en nmol/mol para el CO;
- $x_{i,ISCI_{III}_B}$  es la concentración de gas medida por el analizador ISCI<sub>III</sub>\_B, situado al final de la línea de distribución, en nmol/mol para el SO<sub>2</sub> y en nmol/mol para el CO ;
- $u_{ISCI_{III}_A}$  es la incertidumbre típica estimada para la concentración de gas medida por el analizador ISCI<sub>III</sub>\_A, situado al inicio de la línea de distribución, en nmol/mol para el SO<sub>2</sub> y en nmol/mol para el CO;
- $u_{ISCI_{III}_B}$  es la incertidumbre típica estimada para la concentración de gas medida por el analizador ISCI<sub>III</sub>\_B, situado al final de la línea de distribución, en nmol/mol para el SO<sub>2</sub> y en nmol/mol para el CO.

Los criterios de aceptación son:

$D \leq 2$  las concentraciones medidas por los analizadores ISCI<sub>III</sub>\_A y ISCI<sub>III</sub>\_B son equivalentes y se ha producido una distribución uniforme de la mezcla;

D > 2 las concentraciones medidas por los analizadores ISCIII\_A y ISCIII\_B no son equivalentes.

A partir de los resultados obtenidos en el ensayo de uniformidad se determina la incertidumbre debida a la falta de uniformidad que será considerada en la determinación de la incertidumbre típica del valor asignado.

La tabla 14 muestra los resultados obtenidos por los analizadores ISCIII\_A e ISCIII\_B, situados al inicio y al final de la línea de distribución, respectivamente, para las concentraciones ensayadas de NO durante la intercomparación, la diferencia absoluta entre ambos y el valor del estadístico D.

	ISCIII_A		ISCIII_B		Dif. absoluta	D
	NO	u <sub>ISCIII_A</sub>	NO	u <sub>ISCIII_B</sub>	nmol/mol	
<b>c1</b>	214,47	5,03	212,55	5,00	1,91	0,3
<b>c2</b>	117,08	2,81	117,89	3,56	0,81	0,2
<b>c3</b>	149,71	3,55	148,45	3,53	1,26	0,3
<b>c4</b>	67,74	1,73	67,32	1,75	0,42	0,2
<b>c5</b>	263,31	6,15	261,98	6,12	1,33	0,2

Tabla 14.- Resultados obtenidos por los analizadores ISCIII\_A e ISCIII\_B, diferencia absoluta entre ambos y valor del estadístico D, para cada concentración de NO generada

Todos los valores del estadístico D son inferiores a 2, por lo que no existe evidencia de que se haya producido una distribución no uniforme de las diferentes mezclas de gas NO generadas a lo largo del distribuidor de muestra.

La incertidumbre típica de uniformidad estimada para la distribución de las mezclas de SO<sub>2</sub>, a partir de los resultados obtenidos es u<sub>uniformidad</sub> = 0,4 %.

La tabla 15 muestra los resultados obtenidos por los analizadores ISCIII\_A e ISCIII\_B, situados al inicio y al final de la línea de distribución, respectivamente, para las concentraciones ensayadas de NO<sub>2</sub> durante la intercomparación, la diferencia absoluta entre ambos y el valor del estadístico D.

	ISCIII_A		ISCIII_B		Dif. absoluta nmol/mol	D
	NO <sub>2</sub>	u <sub>ISCIII_A</sub>	NO <sub>2</sub>	u <sub>ISCIII_B</sub>		
c1	105,49	4,36	99,53	4,40	5,96	1,0
c2	53,19	2,28	51,86	2,75	1,33	0,4
c3	180,52	7,38	169,57	7,41	10,96	1,0
c4	80,37	3,35	76,07	3,43	4,31	0,9
c5	155,73	6,38	147,19	6,46	8,54	0,9

Tabla 16.- Resultados obtenidos por los analizadores ISCIII\_A e ISCIII\_B, diferencia absoluta entre ambos y valor del estadístico D, para cada concentración de CO generada

Todos los valores del estadístico D son inferiores a 2, por lo que no existe evidencia de que se haya producido una distribución no uniforme de las diferentes mezclas de gas NO<sub>2</sub> generadas a lo largo del distribuidor de muestra.

La incertidumbre típica de uniformidad estimada para la distribución de las mezclas de CO, a partir de los resultados obtenidos es  $U_{\text{uniformidad}} = 2,9 \%$ .

### 5.5.2 Determinación del valor asignado como valor de referencia y de su incertidumbre típica

Se entiende por valor asignado ( $c_i$ ), el valor atribuido como concentración de referencia a cada una de las concentraciones ensayadas, y que junto con su incertidumbre típica ( $u_{c_i}$ ) se ajusta al propósito del ejercicio de intercomparación.

Para la determinación del valor asignado se emplean como valores de referencia los determinados por los analizadores del ACA con trazabilidad a materiales de referencia certificados.

Para cada concentración de gas, el valor asignado se determina como el valor promedio de las mediciones realizadas por el analizador ISCIII\_A y el analizador ISCIII\_B:

$$c_i = \frac{x_{i,ISCIII\_A} + x_{i,ISCIII\_B}}{2}$$



donde

$c_i$  es el valor asignado para cada concentración ensayada de NO o NO<sub>2</sub>, según corresponda, durante el ejercicio de intercomparación, en nmol/mol o nmol/mol.

$X_{i,ISCI\text{III\_A}}$  es la concentración medida de NO o NO<sub>2</sub>, según corresponda, por el analizador ISCI\text{III\\_A}, en nmol/mol o nmol/mol.

$X_{i,ISCI\text{III\_B}}$  es la concentración medida de NO o NO<sub>2</sub>, según corresponda, por el analizador ISCI\text{III\\_B}, en nmol/mol o nmol/mol.

La incertidumbre típica de medida de la mezcla de gas se determina para cada analizador, a partir de la incertidumbre típica de calibración del analizador y de la incertidumbre típica de repetibilidad de las 3 mediciones que se informan. Finalmente, la incertidumbre típica del valor asignado, se calcula considerando las incertidumbres típicas de medida con cada analizador y la incertidumbre típica de uniformidad descrita en el apartado 5.5.1.

Las tablas 16 y 17 muestran los valores asignados y la incertidumbre típica asociada a los mismos, para cada concentración generada de NO y NO<sub>2</sub> respectivamente.

	NO	
	$c_i$ (nmol/mol)	$u_{c_i}$ (nmol/mol)
<b>c1</b>	213,51	3,66
<b>c2</b>	117,49	2,32
<b>c3</b>	149,08	2,58
<b>c4</b>	67,53	1,26
<b>c5</b>	262,64	4,47

Tabla 16.- Valor asignado e incertidumbre típica asociada al mismo, para cada concentración generada de NO

	NO <sub>2</sub>	
	c <sub>i</sub> (nmol/mol)	u <sub>ci</sub> (nmol/mol)
c1	102,51	4,31
c2	52,52	2,36
c3	175,04	7,32
c4	78,22	3,32
c5	151,46	6,34

Tabla 17.- Valor asignado e incertidumbre típica asociada al mismo, para cada concentración generada de NO<sub>2</sub>

### 5.5.3 Comprobación por comparación del valor asignado y su incertidumbre típica con parámetros obtenidos por estadística robusta

El valor asignado para cada una de las concentraciones ensayadas se compara con el valor obtenido por métodos estadísticos robustos que evitan la influencia de valores extremos. Para la determinación de la media robusta ( $x^*$ ) y de su desviación típica ( $s^*$ ), se han seguido las directrices establecidas en el Algoritmo A del Anexo C de la Norma ISO 13528:2015, que se apoya en propiedades de la mediana que no se ven afectados por el tipo de población existente.

El sistema del algoritmo A, establecido en la Norma ISO 13528, se basa en la realización de un proceso iterativo hasta la convergencia de los datos obtenidos, para finalmente obtener un valor central como media y una desviación típica robusta, a partir de los datos de los laboratorios participantes.

Seguidamente, se determina la diferencia entre la media robusta y el valor asignado, ( $|x^* - c_i|$ ) y la incertidumbre típica de dicha diferencia ( $u(x^* - c_i)$ ) estimada de acuerdo con la ecuación:

$$u_{(x^* - c_i)} = \sqrt{\frac{(1,25 \times s^*)^2}{p} + u_{c_i}^2}$$

donde

$s^*$  es la desviación típica de la media robusta  $x^*$

$p$  es el número de mediciones realizadas

$u_{ci}$  es la incertidumbre típica del valor asignado

si la diferencia  $|x^* - c_i|$  es menor o igual a dos veces su incertidumbre se considera correcto el valor asignado ( $c_i$ ), si es superior a dos se debe investigar el motivo y se toma como valor asignado el valor obtenido para  $x^*$ .

Las tablas 18 y 19, muestran los valores asignados  $c_i$  y su incertidumbre típica asociada  $u_{ci}$ , la media robusta ( $x^*$ ) y la desviación típica robusta ( $s^*$ ) obtenida tras la aplicación del algoritmo A, la diferencia  $|x^* - c_i|$ , y el cumplimiento con el criterio de aceptación establecido para la aceptación del valor asignado de NO y NO<sub>2</sub>, respectivamente.

	$c_i$ (nmol/mol)	$u_{ci}$ (nmol/mol)	$x^*$ (nmol/mol)	$s^*$ (nmol/mol)	$u_{x^*}$ (nmol/mol)	$x^* - c_i$ (nmol/mol)	$u_{x^* - c_i}$ (nmol/mol)	<b>CUMPLIMIENTO</b> $x^* - c_i < 2 * u_{x^* - c_i}$
c1	213,51	3,66	206,02	1,71	0,87	7,49	3,86	<i>CORRECTO</i>
c2	117,49	2,32	112,34	2,51	1,28	5,15	2,94	<i>CORRECTO</i>
c3	149,08	2,58	144,19	2,27	1,16	4,89	3,06	<i>CORRECTO</i>
c4	67,53	1,26	64,71	1,44	0,73	2,82	1,63	<i>CORRECTO</i>
c5	262,64	4,47	254,91	3,92	2,00	7,74	5,29	<i>CORRECTO</i>

Tabla 18.- Valor asignado, incertidumbre típica del valor asignado, media robusta, desviación típica robusta, diferencia  $|x^* - c_i|$ , incertidumbre típica de la diferencia  $|x^* - c_i|$  y resultado y cumplimiento del criterio de aceptación del valor asignado para NO

Todos los valores asignados  $c_i$  son compatibles con los valores obtenidos por estadística robusta, por lo que la evaluación del desempeño se realizará tomando como valores asignados de NO e incertidumbres típicas de los mismos, los valores medidos por los analizadores del ISCIII que se mostraban en la tabla 16.

	ci (nmol/mol)	uci (nmol/mol)	x* (nmol/mol)	s* (nmol/mol)	ux* (nmol/mol)	x*-ci (nmol/mol)	u x*-ci (nmol/mol)	CUMPLIMIENTO x* - ci < 2 * u x*-ci
c1	102,51	4,31	103,50	2,75	1,40	0,99	4,75	CORRECTO
c2	52,52	2,36	52,98	2,18	1,11	0,46	2,83	CORRECTO
c3	175,04	7,32	175,32	3,07	1,57	0,28	7,65	CORRECTO
c4	78,22	3,32	79,16	1,59	0,81	0,94	3,51	CORRECTO
c5	151,46	6,34	151,56	2,56	1,31	0,10	6,61	CORRECTO

Tabla 19.- Valor asignado, incertidumbre típica del valor asignado, media robusta, desviación típica robusta, diferencia  $|x^* - c_i|$ , incertidumbre típica de la diferencia  $|x^* - c_i|$  y resultado y cumplimiento del criterio de aceptación del valor asignado para NO<sub>2</sub>

Todos los valores asignados  $c_i$  son compatibles con los valores obtenidos por estadística robusta, por lo que la evaluación del desempeño se realizará tomando como valores asignados de CO e incertidumbre típica de los mismos, los valores medidos por los analizadores del ISCIII que se mostraban en la tabla 17.

#### 5.5.4 Determinación de la desviación típica para la evaluación del desempeño

Para la determinación de la desviación típica objetivo, se ha seguido el procedimiento usado por la Asociación de Laboratorios Nacionales de Referencia de Calidad del Aire en Europa (AQUILA), específico para ejercicios de intercomparación de gases en aire ambiente, según el cual la desviación típica se determina para el rango de aplicación de la comparación, por regresión lineal.

La regresión lineal se ha realizado entre el valor máximo que permite la norma de impureza para el aire cero y la incertidumbre máxima que permite la norma para la calibración de gases en el punto de calibración (75 % del rango), es decir, una incertidumbre máxima expandida del 5%.

La dispersión se calcula según la siguiente ecuación para cada concentración [ ] ensayada durante la comparación.

$$\hat{\sigma} = a x [ ] + b$$

donde



- $\hat{\sigma}$  es la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación
- a es la pendiente obtenida de la regresión lineal
- b es el término independiente de la regresión lineal
- [ ] es la concentración ensayada durante la comparación

Los valores de a y b obtenidos para el presente ejercicio de intercomparación son:

Para NO: a = 0,006 y b = 1

Para NO<sub>2</sub>: a = 0,004 y b = 1

Las tablas 20 y 21 muestran los valores de  $\hat{\sigma}$  obtenidos para cada concentración de NO y NO<sub>2</sub> respectivamente. El valor de  $\hat{\sigma}$  obtenido se utilizará para la determinación del estadístico de desempeño z'score, pertinente.

	$\hat{\sigma}$ (NO)
c1	2,2
c2	1,6
c3	1,8
c4	1,4
c5	2,4

Tabla 20.- Valores de  $\hat{\sigma}$  obtenidos para cada concentración de NO

	$\hat{\sigma}$ (NO <sub>2</sub> )
c1	1,4
c2	1,2
c3	1,6
c4	1,3
c5	1,5

Tabla 21.- Valores de  $\hat{\sigma}$  obtenidos para cada concentración de NO<sub>2</sub>

La evaluación del desempeño de los laboratorios participantes, se realiza a partir de los siguientes estadísticos:

- Estimación del sesgo del laboratorio
- Determinación del z'score
- Número  $E_n$

### 6.1 Estimación del sesgo del laboratorio

Considerando  $x_i$  como el resultado informado por los laboratorios participantes para cada concentración de gas ensayada, se estima el sesgo  $S$  como:

$$S = x_i - c_i$$

donde  $c_i$  es el valor asignado.

Los criterios establecidos para la evaluación del sesgo son:

$ S  \leq 2,0 \times \hat{\sigma}$	Resultados satisfactorios
$3,0 \times \hat{\sigma} \geq  S  > 2,0 \times \hat{\sigma}$	Resultados cuestionables
$ S  > 3,0 \times \hat{\sigma}$	Resultados no satisfactorios

#### 6.1.1 Monóxido de nitrógeno

Las tablas 22, 23, 24, 25 y 26 muestran el valor del sesgo ( $S$ ) expresado en nmol/mol y el error relativo (ER) expresado en %, obtenidos por cada uno de los participantes con respecto al valor asignado a cada concentración de NO.

c1	$x^* = 213,51$	EA	ER
A_3	209,32	4,19	2,0%
B_3	205,01	8,50	4,0%
C_3	210,49	3,02	1,4%
D_3	204,30	9,21	4,3%
E_3	205,00	8,51	4,0%
F_3	206,24	7,27	3,4%

Tabla 22. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c1 de NO (213,51 nmol/mol)



INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)



c2	x* = 117,49	EA	ER
A_3	111,80	5,69	4,8%
B_3	116,51	0,98	0,8%
C_3	113,98	3,51	3,0%
D_3	110,49	7,00	6,0%
E_3	109,90	7,59	6,5%
F_3	112,07	5,42	4,6%

Tabla 23. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c2 de NO (117,49 nmol/mol)

c3	x* = 149,08	EA	ER
A_3	144,27	4,81	3,2%
B_3	150,27	-1,19	-0,8%
C_3	145,54	3,54	2,4%
D_3	142,44	6,64	4,5%
E_3	142,00	7,08	4,7%
F_3	143,53	5,55	3,7%

Tabla 24. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c3 de NO (149,08 nmol/mol)

c4	x* = 67,50	EA	ER
A_3	63,46	4,07	6,0%
B_3	74,78	-7,25	-10,7%



INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)



C_3	65,74	1,79	2,7%
D_3	64,27	3,26	4,8%
E_3	63,50	4,03	6,0%
F_3	64,65	2,88	4,3%

Tabla 25. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c4 de NO (67,50 nmol/mol)

c5	x* = 262,64	EA	ER
A_3	256,75	5,89	2,2%
B_3	258,53	4,11	1,6%
C_3	258,00	4,64	1,8%
D_3	251,89	10,75	4,1%
E_3	250,00	12,64	4,8%
F_3	254,26	8,38	3,2%

Tabla 26. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c5 de NO (262,64 nmol/mol)

Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 muestran el grado de cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos para la evaluación del sesgo de los participantes, para cada una de las concentraciones ensayadas.

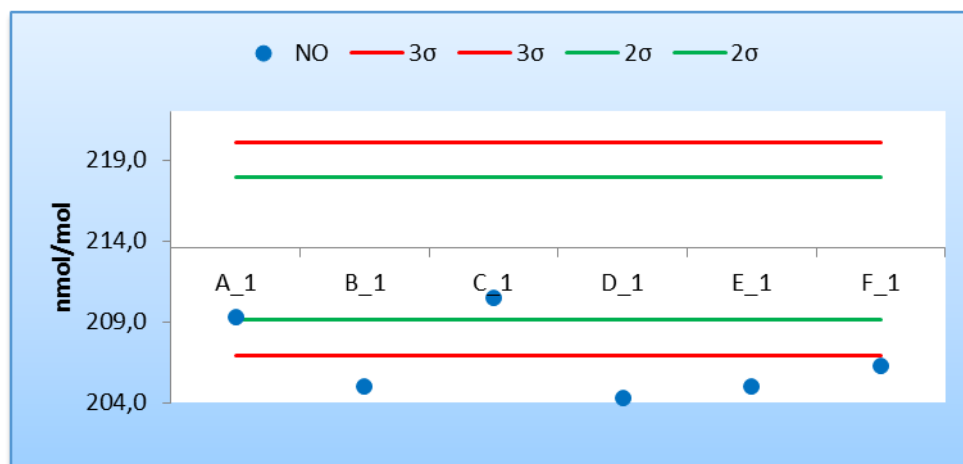




Figura 1 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c1 de NO (213,51 nmol/mol)

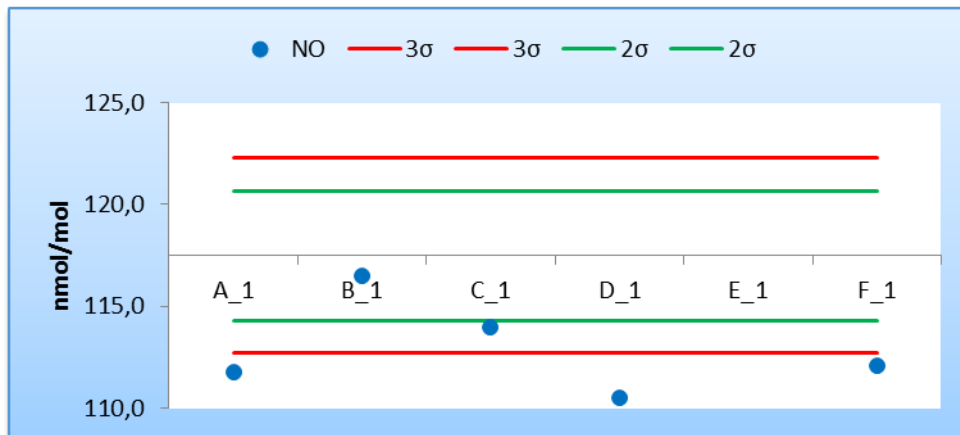


Figura 2 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c2 de NO (117,49 nmol/mol)

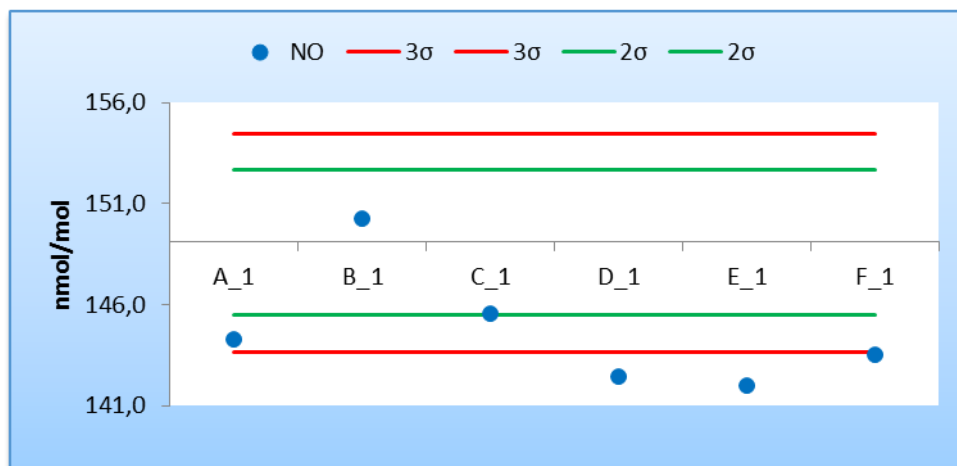


Figura 3 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c3 de NO (149,08 nmol/mol)

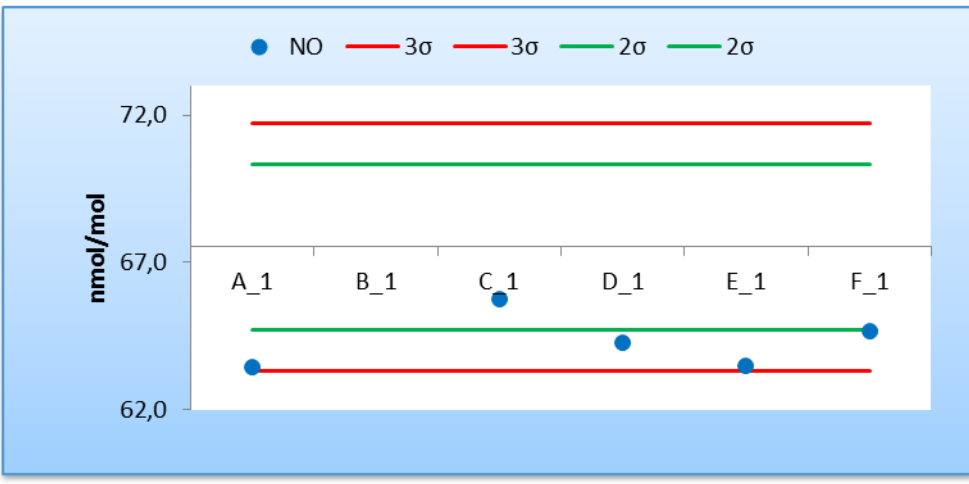


Figura 4 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c4 de NO (67,53 nmol/mol)

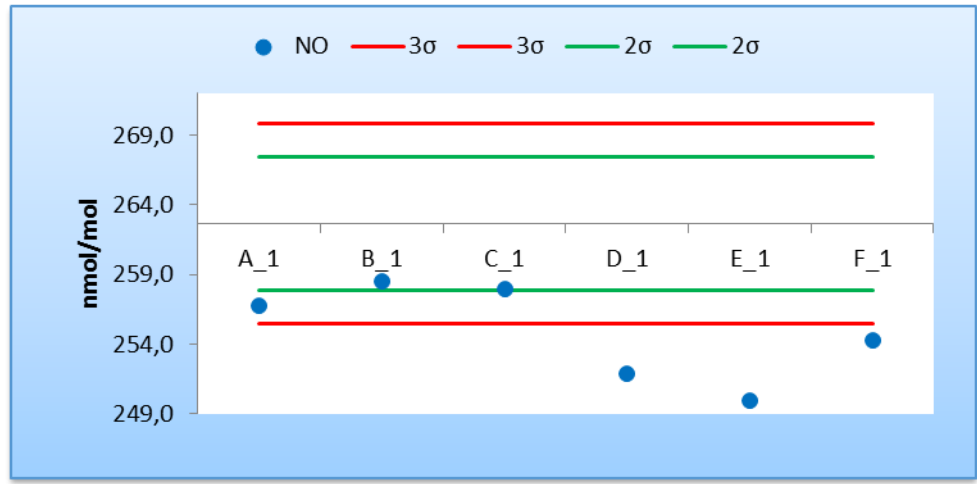


Figura 5 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c5 de NO (262,64 nmol/mol)

La tabla 27, muestra un resumen de los resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de sesgo en la intercomparación de nO.

	c1	c2	c3	c4	c5
A_1	Satisfactorio	No Satisfactorio	Cuestionable	Cuestionable	Cuestionable

B_1	No satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	No Satisfactorio	Satisfactorio
C_1	Satisfactorio	Cuestionable	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
D_1	No satisfactorio	No satisfactorio	No satisfactorio	Cuestionable	No satisfactorio
E_1	No satisfactorio	No satisfactorio	No satisfactorio	Cuestionable	No satisfactorio
F_1	No satisfactorio	No satisfactorio	No satisfactorio	Cuestionable	No satisfactorio

Tabla 27.- Resultados de sesgo obtenidos por los participantes para las distintas concentraciones de NO ensayadas

Los participantes D\_1, E\_1 y F\_1 obtienen valores no satisfactorios de sesgo para todas las concentraciones, excepto la c4 para la que obtiene un valor cuestionable. El participante a\_1 obtiene valores cuestionables de sesgo para todas las concentraciones, excepto la c1 para la que obtiene un valor satisfactorio y la c2 que obtiene un valor No Satisfactorio. El participante B1 obtiene un valor satisfactorio para las concentraciones c2, c3 y c5, obteniendo un valor no satisfactorio para las concentraciones c1 y c4. El participante C1 obtiene valores satisfactorios para todas las concentraciones, excepto la c2 que es cuestionable.

### 6.1.2 Dióxido de nitrógeno

Las tablas 28, 29, 30, 31 y 32 muestran el valor del sesgo (S) expresado en nmol/mol y el error relativo (ER) expresado en %, obtenidos por cada uno de los participantes con respecto al valor asignado a cada concentración de NO<sub>2</sub>.

c1	x* = 102,51	EA	ER
A_3	106,65	-4,14	-4,0%
B_3	102,56	-0,05	0,0%
C_3	103,71	-1,20	-1,2%
D_3	105,62	-3,11	-3,0%
E_3	96,57	5,94	5,8%
F_3	102,70	-0,19	-0,2%

Tabla 28. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c1 de NO<sub>2</sub> (102,51 nmol/mol)



INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)



c2	x* = 52,52	EA	ER
A_3	54,68	-2,16	-4,1%
B_3	52,85	-0,33	-0,6%
C_3	52,24	0,28	0,5%
D_3	55,95	-3,43	-6,5%
E_3	46,40	6,12	11,7%
F_3	52,64	-0,12	-0,2%

Tabla 29. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c2 de NO<sub>2</sub> (52,52 nmol/mol)

c3	x* = 175,04	EA	ER
A_3	178,88	-3,84	-2,2%
B_3	172,63	2,41	1,4%
C_3	176,31	-1,27	-0,7%
D_3	176,85	-1,81	-1,0%
E_3	168,00	7,04	4,0%
F_3	175,58	-0,54	-0,3%

Tabla 30. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c3 de NO<sub>2</sub> (175,04 nmol/mol)



INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL III  
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE  
MÓNOXIDO DE NITROGENO Y DIÓXIDO DE  
NITROGENO. GRUPO 1. (2018)



c4	x* = 78,2	EA	ER
A_3	80,48	-2,26	-2,9%
B_3	78,72	-0,50	-0,6%
C_3	79,02	-0,80	-1,0%
D_3	82,13	-3,91	-5,0%
E_3	72,40	5,82	7,4%
F_3	78,86	-0,64	-0,8%

Tabla 31. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c4 de NO<sub>2</sub> (78,20 nmol/mol)

c5	x* = 151,46	EA	ER
A_3	154,07	-2,61	-1,7%
B_3	150,41	1,05	0,7%
C_3	152,06	-0,60	-0,4%
D_3	153,69	-2,23	-1,5%
E_3	145,00	6,46	4,3%
F_3	151,18	0,28	0,2%

Tabla 32. – Sesgo y error relativo de los participantes para la concentración c5 de NO<sub>2</sub> (151,46 nmol/mol)

Las figuras 6, 7, 8, 9 y 10 muestran el grado de cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos para la evaluación del sesgo de los participantes, para cada una de las concentraciones de NO<sub>2</sub> ensayadas.

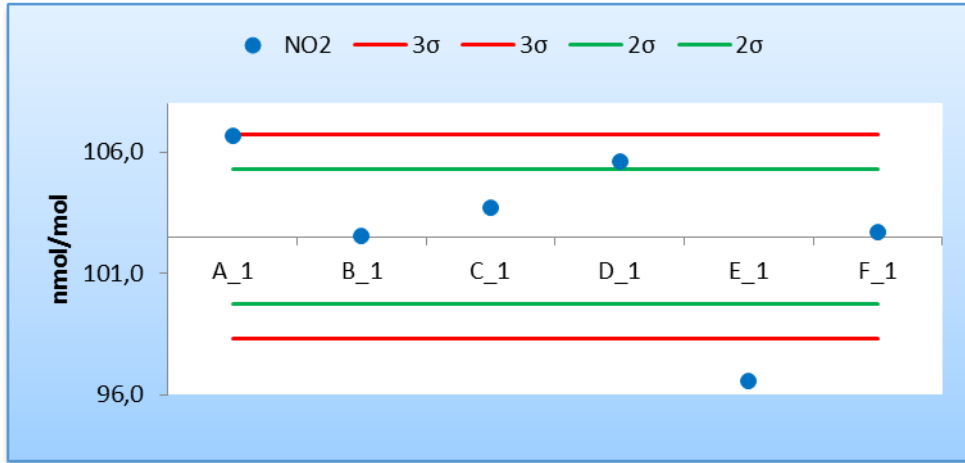


Figura 6 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c1 de NO<sub>2</sub> (102,51 nmol/mol)

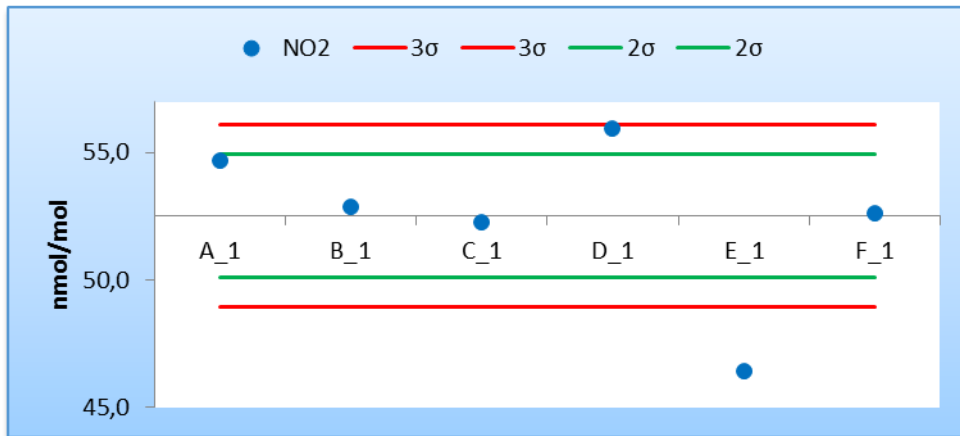


Figura 7 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c2 de NO<sub>2</sub> (52,52 nmol/mol)

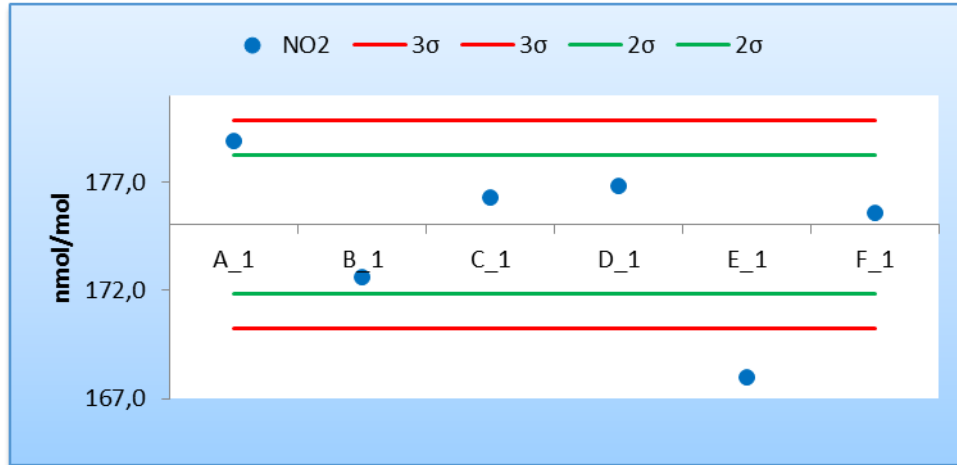


Figura 8 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c3 de NO<sub>2</sub> (175,04 nmol/mol)

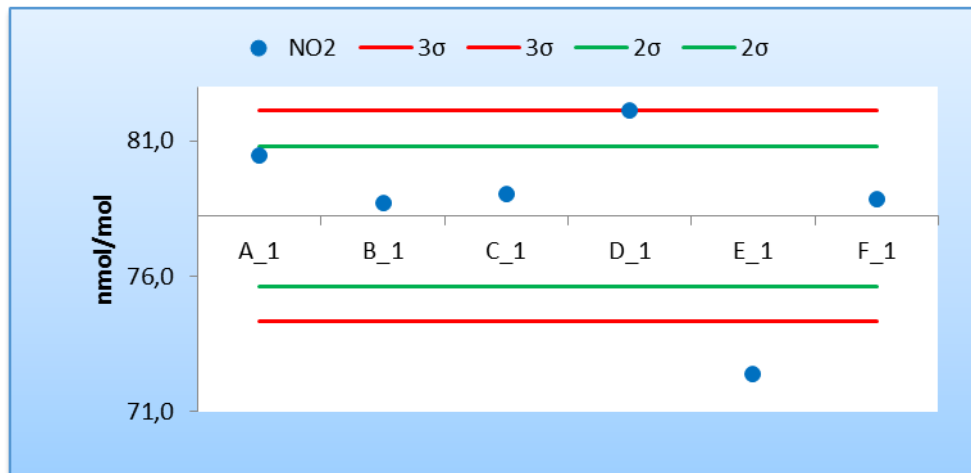


Figura 9 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c4 de NO<sub>2</sub> (78,82 nmol/mol)

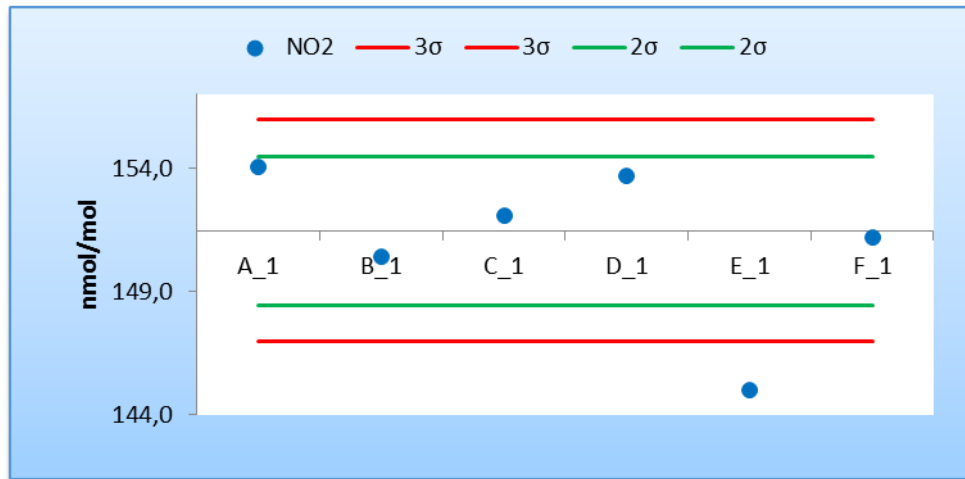


Figura 10 - Resultados y cumplimiento de los criterios de aceptación de sesgo de los laboratorios participantes para la concentración c5 de NO<sub>2</sub> (151,46 nmol/mol)

La tabla 34, muestra un resumen de los resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de sesgo en la intercomparación de NO<sub>2</sub>.

	c1	c2	c3	c4	c5
A_1	Cuestionable	Satisfactorio	Cuestionable	Satisfactorio	Satisfactorio
B_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
D_1	Cuestionable	Cuestionable	Satisfactorio	No Satisfactorio	Satisfactorio
E_1	No Satisfactorio	No Satisfactorio	No Satisfactorio	No Satisfactorio	No Satisfactorio
F_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio

Tabla 34.- Resultados de sesgo obtenidos por los participantes para las distintas concentraciones de CO ensayadas

Los participantes B\_1 y F\_1 obtienen valores satisfactorios de sesgo para todas las concentraciones. El participante A\_1 obtiene un valor cuestionable para las concentraciones c1 y c3. El participante D\_1 obtiene valores satisfactorios para las concentraciones c3 y c5, cuestionable para las concentraciones c1 y c2 y no satisfactorio para la concentración c4. El participante E\_1 obtiene valores no satisfactorios para todas las concentraciones.

## 6.2 z' score

La determinación del z' score se realiza para comparar el desempeño del laboratorio participante con respecto al resto de participantes, teniendo en cuenta la desviación típica objetivo del ejercicio de



intercomparación y la incertidumbre del valor asignado. El valor de z'score se calcula para cada concentración ensayada según la ecuación:

$$z' \text{ score} = \frac{|x_i - c_i|}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 + u_x^2}} = \frac{|x_i - c_i|}{\sqrt{(a \times [C] + b)^2 + u_x^2}}$$

donde

- $x_i$  es la concentración informada por cada participante, en nmol/mol.
- $c_i$  es el valor asignado, en nmol/mol.
- $\hat{\sigma}$  es la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación, en nmol/mol.
- $a$  es la pendiente obtenida de la regresión lineal
- $b$  es el termino independiente de la regresión lineal  $u_{ci}$  es la incertidumbre típica del valor asignado
- $u_x$  es la incertidumbre típica del valor asignado, en nmol/mol.

Los criterios establecidos para la evaluación del z'score son:

- $|z' \text{ score}| \leq 2$ : resultados satisfactorios
- $2 < |z' \text{ score}| \leq 3$ : resultados cuestionables
- $|z' \text{ score}| > 3$ : resultados no satisfactorios

### 6.2.1 Monóxido de nitrógeno

Los resultados de z'score se muestran en la figura 11, para todas las concentraciones de SO<sub>2</sub> ensayadas y agrupadas por participantes.

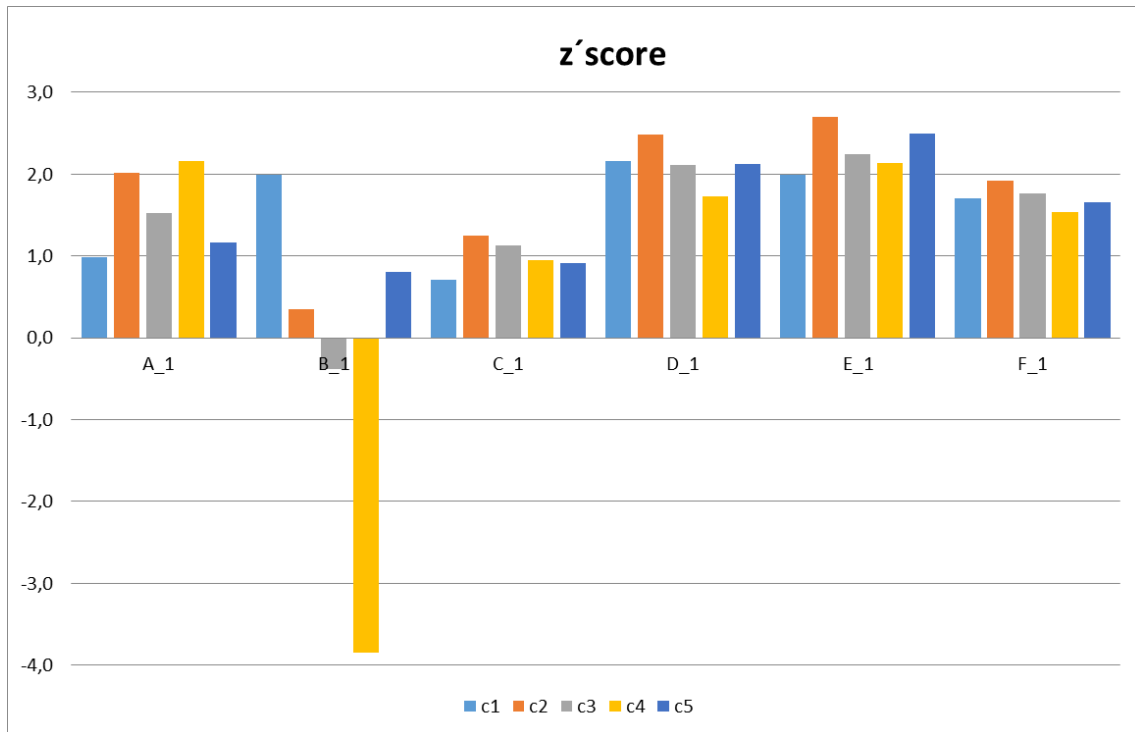


Figura 11 - Resultados de z'score para todos los participantes y todas las concentraciones de NO ensayadas

La tabla 34, muestra un resumen de los resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de z'score en la intercomparación de NO.

	c1	c2	c3	c4	c5
A_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Cuestionable	Satisfactorio
B_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	No Satisfactorio	Satisfactorio
C_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
D_1	Satisfactorio	Cuestionable	Cuestionable	Cuestionable	Cuestionable
E_1	Satisfactorio	Cuestionable	Cuestionable	Cuestionable	Cuestionable
F_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio

Tabla 34.- Resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de z'score en la intercomparación de NO.

*El participante A\_1 obtiene un valor de z'score cuestionable para la concentración c4 y satisfactorio para el resto de las concentraciones. El participante B\_1 obtiene un valor de z'score No satisfactorio para la concentración c4 y satisfactorio para el resto de las concentraciones. Los participantes D\_1 y F\_1 obtienen un valor de z'score cuestionable para las concentraciones c2, c3, c4 y c5. Los participantes C\_1 y F\_1 obtienen un valor de z'score satisfactorio para todas las concentraciones.*

### 6.2.2 Dióxido de nitrógeno

Los resultados de z'score se muestran en la figura 12, para todas las concentraciones de NO<sub>2</sub> ensayadas y agrupadas por participantes.

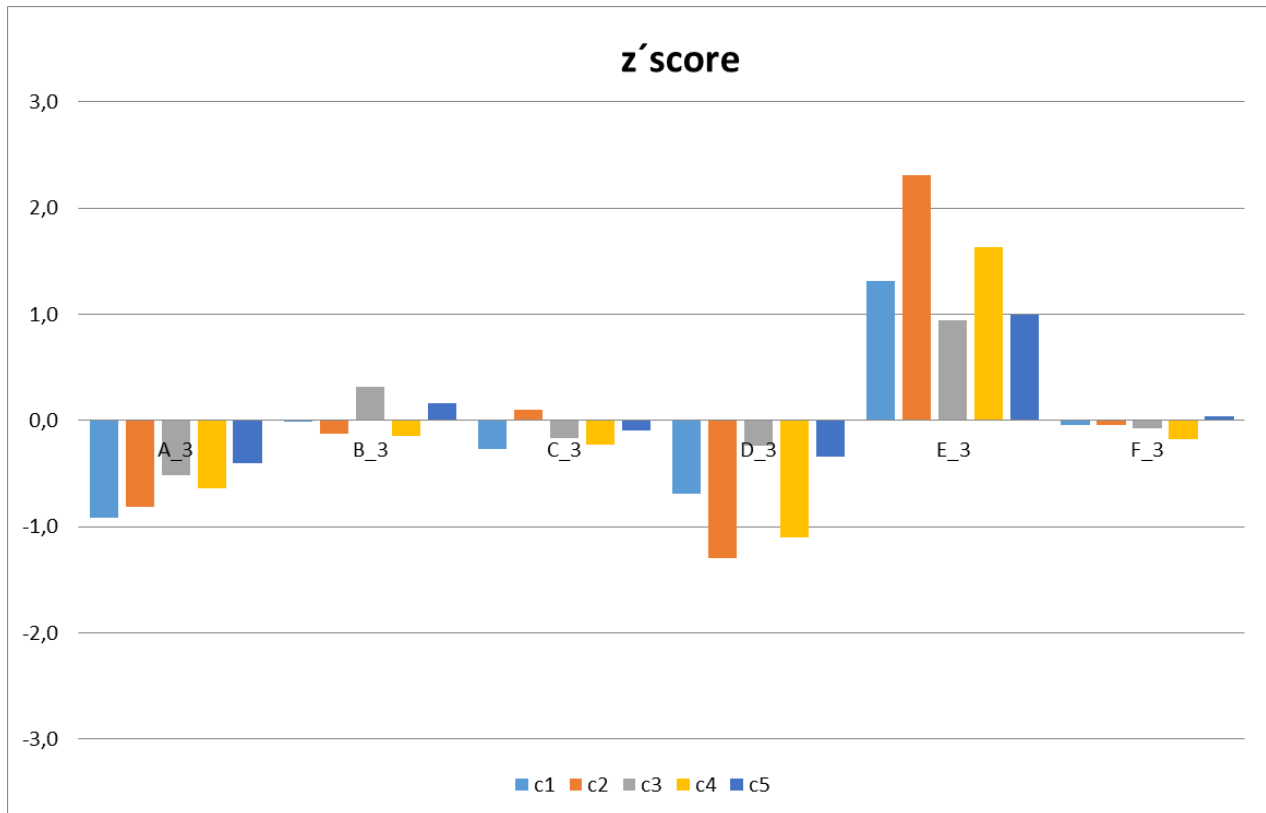


Figura 12 - Resultados de z'score para todos los participantes y todas las concentraciones de NO<sub>2</sub> ensayadas

La tabla 35, muestra un resumen de los resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de z'score en la intercomparación de NO<sub>2</sub>.

	C1	C2	C3	C4	C5
A_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
B_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
C_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio

D_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
E_1	Satisfactorio	Cuestionable	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio
F_1	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio

Tabla 35.- Resultados obtenidos por los distintos participantes para el valor de z`score en la intercomparación de NO<sub>2</sub>

*Todos los participantes obtienen valores de z`scores satisfactorios excepto el participante E\_1 que obtiene un valor cuestionable para la concentración c2.*

### 6.3 Número E<sub>n</sub>

La determinación del estadístico E<sub>n</sub> permite evaluar la compatibilidad del valor medido por los participantes y el valor asignado, considerando la incertidumbre de medida asignada a ambos. Se realiza de acuerdo con la ecuación:

$$E_n = \frac{|x_i - c_i|}{\sqrt{U_{xi}^2 + U_{ci}^2}}$$

donde

x<sub>i</sub> es el valor medido por cada uno de los participantes, en nmol/mol.

c<sub>i</sub> es el valor asignado como concentración de referencia, en nmol/mol.

U<sub>xi</sub> es la incertidumbre expandida informada por cada participante, en nmol/mol.

U<sub>ci</sub> es la incertidumbre expandida del valor asignado, en nmol/mol.

Los criterios de aceptación de los valores de E<sub>n</sub> son:

E<sub>n</sub> ≤ 1,0: resultados satisfactorios

E<sub>n</sub> > 1,0: resultados no satisfactorios

### 6.3.1 Monóxido de nitrógeno

La tabla 36 muestra los resultados de  $E_n$  obtenidos por los distintos participantes para todas las concentraciones ensayadas.

En					
	c1	c2	c3	c4	c5
A_1	0,3	0,6	0,4	0,8	0,3
B_1	0,7	0,1	-0,1	-1,6	0,3
C_1	0,3	0,6	0,5	0,6	0,4
D_1	1,1	1,3	1,1	0,9	1,1
E_1	0,6	1,0	0,7	0,9	0,7
F_1	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6

Tabla 36.- Resultados del estadístico  $E_n$  para todos los participantes y todas la concentraciones de NO ensayadas

El participante D\_1 obtiene resultados de  $E_n$  no satisfactorios para todas las concentraciones de NO, excepto para la c4. El resto de los participantes obtienen valores de  $E_n \leq 1,0$  en todos los casos, excepto el B\_1 que obtiene un valor de no satisfactorio para la concentración c4.

En la figura 13, se muestra el sesgo de cada participante  $|x_i - c_i|$  con respecto al denominador de la ecuación del estadístico  $E_n$ . Dicho gráfico, permite observar de manera rápida qué laboratorios obtienen resultados satisfactorios (los laboratorios, en los que las barras de error toquen el eje de abscisas se corresponderán con valores de  $E_n \leq 1,0$ , y por tanto satisfactorios).

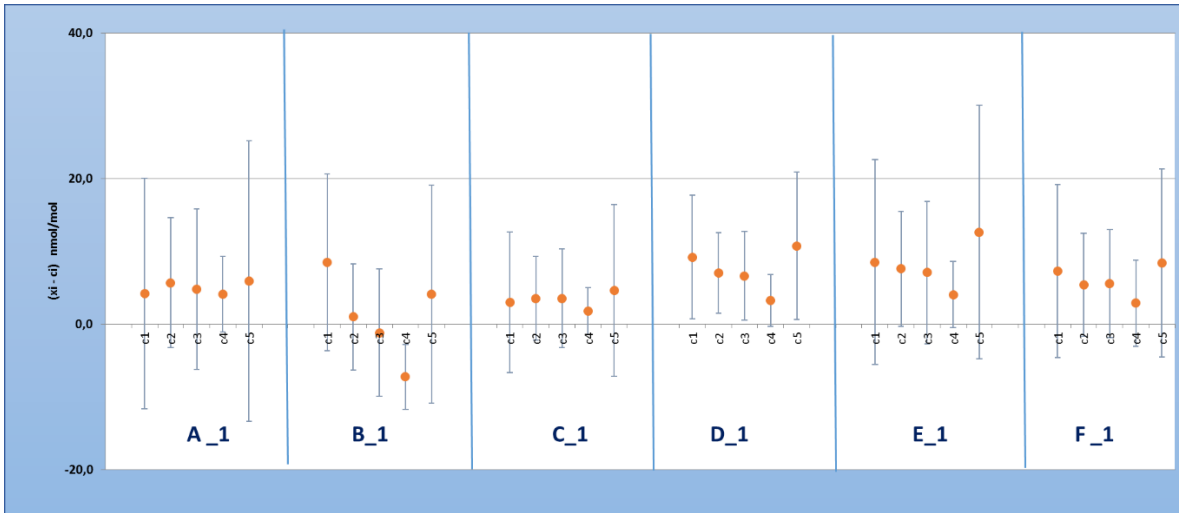


Figura 14.- Representación gráfica del sesgo de cada participante  $|x_i - c_i|$  con respecto al denominador de la ecuación del estadístico  $E_n$  para las concentraciones de NO

### 6.3.2 Dióxido de nitrógeno

La tabla 37 muestra los resultados de  $E_n$  obtenidos por los distintos participantes para todas las concentraciones ensayadas.

En					
	C1	C2	C3	C4	C5
A_1	-0,4	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2
B_1	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1
C_1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
D_1	-0,3	-0,6	-0,1	-0,5	-0,2
E_1	0,5	1,0	0,3	0,6	0,4
F_1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0

Tabla 37.- Resultados del estadístico  $E_n$  para todos los participantes y todas la concentraciones de  $NO_2$  ensayadas.

Todos los participantes obtienen valores de  $E_n \leq 1,0$  en todos los casos.

En la figura 14, se muestra el sesgo de cada participante  $|x_i - c_i|$  con respecto al denominador de la ecuación del estadístico  $E_n$ . Dicho gráfico, permite observar de manera rápida que laboratorios obtienen resultados satisfactorios (los laboratorios, en los que las barras de error toquen el eje de abscisas se corresponderán con valores de  $E_n \leq 1,0$ , y por tanto satisfactorios

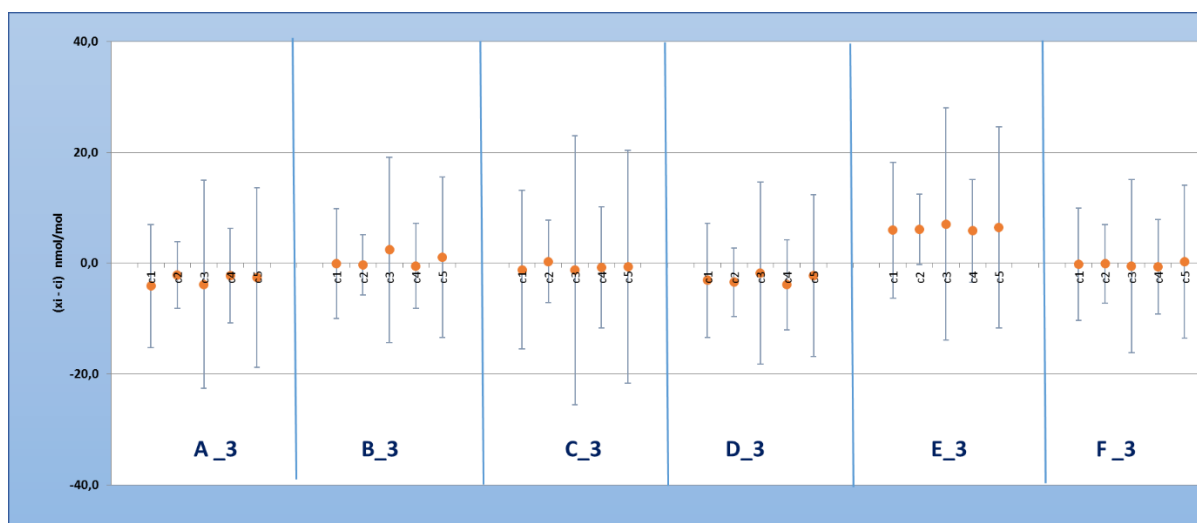


Figura 14.- Representación gráfica del sesgo de cada participante  $|x_i - c_i|$  con respecto al denominador de la ecuación del estadístico  $E_n$  para las concentraciones de  $\text{NO}_2$

#### 6.4 Interpretación de los resultados

Para la interpretación de los resultados del ejercicio de intercomparación a partir de los estadísticos  $z'$ score y  $E_n$ , se ha desarrollado el siguiente diagrama, en el que se establecen 6 categorías (a1 a a6), definidas como:

- a1: resultados completamente satisfactorios ( $z'$ score satisfactorio y  $E_n$  satisfactorio).
- a2: resultados satisfactorios ( $z'$ score satisfactorio), pero  $E_n$  no satisfactorio. El valor de la incertidumbre podría estar subestimado.
- a3: resultados cuestionables ( $z'$ score cuestionable), y  $E_n$  satisfactorio. La incertidumbre informada podría estar sobreestimada.
- a4: resultados cuestionables ( $z'$ score cuestionable), y  $E_n$  no satisfactorio.
- a5: resultados no satisfactorios ( $z'$ score no satisfactorio), y  $E_n$  satisfactorio. La incertidumbre informada podría estar sobreestimada.
- a6: resultados no satisfactorios ( $z'$ score y  $E_n$  no satisfactorios).

La figura 16 muestra el diagrama de categorías establecido para evaluar los resultados de la intercomparación:

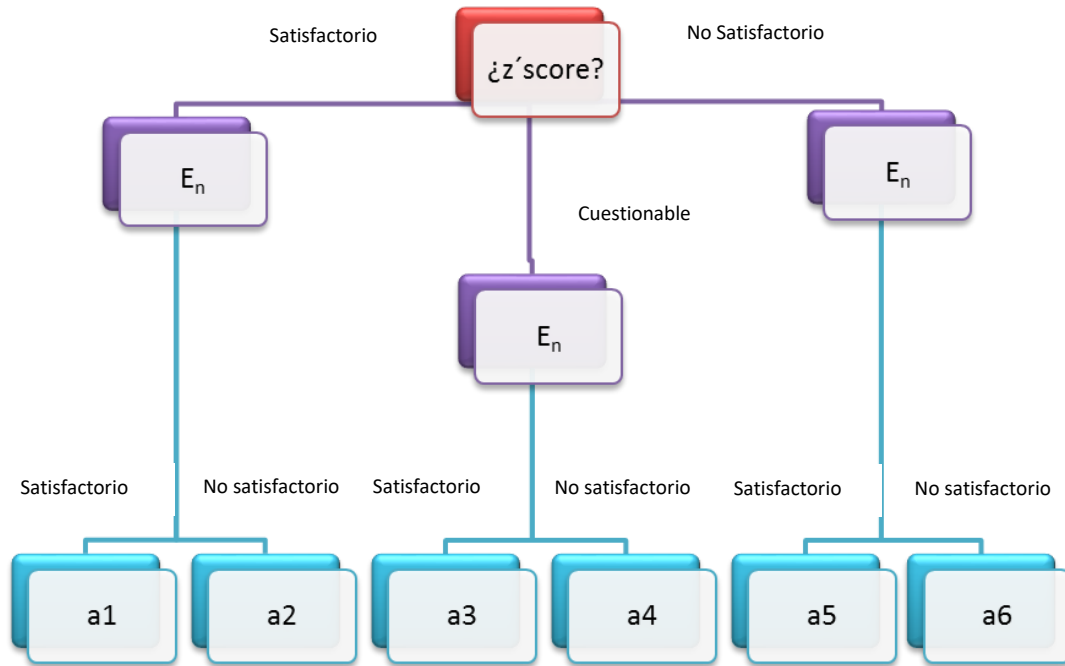


Figura 16.- Diagrama para la evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio de intercomparación

### 6.4.1 Monóxido de nitrógeno

La tabla 38, muestra la categoría obtenida por cada participante para cada una de las concentraciones de NO ensayadas:

Laboratorio participante	Nivel de concentración	Categoría obtenida
A_1	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a3
	c5	a1
B_1	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a6
	c5	a1



<b>C_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1
<b>D_1</b>	c1	a2
	c2	a4
	c3	a4
	c4	a3
	c5	a4
<b>E_1</b>	c1	a1
	c2	a3
	c3	a3
	c4	a3
	c5	a3
<b>F_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1

Tabla 38.- Interpretación de los resultados obtenidos por cada participante para NO

Los participantes C\_1 y F\_1 obtienen para NO, resultados completamente satisfactorios (a1), lo cual se traduce, en un adecuado desempeño teniendo en cuenta la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación y en una adecuada compatibilidad del valor medido por los participantes y el valor asignado, considerando la incertidumbre de medida de ambos.

El participante A\_1 obtiene calificación a3 para la concentración c4, lo que podría indicar que la incertidumbre informada puede estar sobrestimada.

El participante B\_1 obtiene calificación a6 para la concentración c4.

El participante D\_1 obtiene la calificación a4 para las concentraciones c2, c3 y c5, a3 para la concentración c4 y a2 para la concentración c1.

El participante E\_1 obtiene calificación a3 para las concentraciones c2, c3, c4 y c5 lo que podría indicar, teniendo en cuenta la desviación típica objeto del ejercicio, que el desempeño no es adecuado y que las incertidumbres informadas pueden estar sobrestimadas.

#### 6.4.2 Dióxido de nitrógeno

La tabla 39, muestra la categoría obtenida por cada participante para cada una de las concentraciones de CO ensayadas:

Laboratorio participante	Nivel de concentración	Categoría obtenida
<b>A_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1

	c4	a1
	c5	a1
<b>B_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1
<b>D_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1
<b>E_1</b>	c1	a1
	c2	a3
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1
<b>F_1</b>	c1	a1
	c2	a1
	c3	a1
	c4	a1
	c5	a1

Tabla 39.- Interpretación de los resultados obtenidos por cada participante para NO<sub>2</sub>

Los participantes A\_1, B\_1, C\_1, D\_1 y F\_1 obtienen para NO, resultados completamente satisfactorios (a1), lo cual se traduce, en un adecuado desempeño teniendo en cuenta la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación y en una adecuada compatibilidad del valor medido por los participantes y el valor asignado, considerando la incertidumbre de medida de ambos.

El participante E\_1 obtiene calificación a3 para la concentración c2 lo que podría indicar, teniendo en cuenta la desviación típica objeto del ejercicio, que el desempeño no es adecuado y que las incertidumbres informadas pueden estar sobreestimadas, para el resto de concentraciones se obtienen valores a1.

## 7 CONCLUSIONES

A partir de los resultados del ejercicio de intercomparación de NO y de acuerdo con el modelo para la interpretación de los resultados del ejercicio de intercomparación de NO a partir de los estadísticos z' score y E<sub>n</sub>, se concluye que:

- Los participantes C\_1 y F\_1 obtienen para NO, resultados completamente satisfactorios (a1), lo cual se traduce, en un adecuado desempeño teniendo en cuenta la desviación típica objetivo del ejercicio

*de intercomparación y en una adecuada compatibilidad del valor medido por los participantes y el valor asignado, considerando la incertidumbre de medida de ambos.*

- *El participante A\_1 obtiene calificación a3 para la concentración c4, lo que podría indicar que la incertidumbre informada puede estar sobrestimada.*
- *El participante B\_1 obtiene calificación a6 para la concentración c4.*
- *El participante D\_1 obtiene la calificación a4 para las concentraciones c2, c3 y c5, a3 para la concentración c4 y a2 para la concentración c1.*
- *El participante E\_1 obtiene calificación a3 para las concentraciones c2, c3, c4 y c5 lo que podría indicar, teniendo en cuenta la desviación típica objeto del ejercicio, que el desempeño no es adecuado y que las incertidumbres informadas pueden estar sobreestimadas.*

A partir de los resultados del ejercicio de intercomparación de NO<sub>2</sub> y de acuerdo con el modelo para la interpretación de los resultados del ejercicio de intercomparación de NO<sub>2</sub> a partir de los estadísticos z´score y E<sub>n</sub>, se concluye que:

- *Los participantes A\_1, B\_1, C\_1, D\_1 y F\_1 obtienen para NO, resultados completamente satisfactorios (a1), lo cual se traduce, en un adecuado desempeño teniendo en cuenta la desviación típica objetivo del ejercicio de intercomparación y en una adecuada compatibilidad del valor medido por los participantes y el valor asignado, considerando la incertidumbre de medida de ambos.*
- *El participante E\_1 obtiene calificación a3 para la concentración c2 lo que podría indicar, teniendo en cuenta la desviación típica objeto del ejercicio, que el desempeño no es adecuado y que las incertidumbres informadas pueden estar sobreestimadas, para el resto de concentraciones se obtienen valores a1.*

## **8 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS**

El ISCIII ha asignado a cada participante un código alfanumérico que solo le ha sido comunicado a él, de modo que pueda consultar sus resultados en el informe y no ser identificado por ningún otro participante u organismo externo sin su consentimiento

Por su parte, la aceptación de participación en estos ejercicios de intercomparación conlleva el compromiso por parte de los participantes de tratar como confidencial cualquier información obtenida durante su estancia en el laboratorio de intercomparaciones, relacionada con la realización y resultados del ejercicio.

Fecha de emisión: 7 de mayo de 2018